


Microbiología Clínica

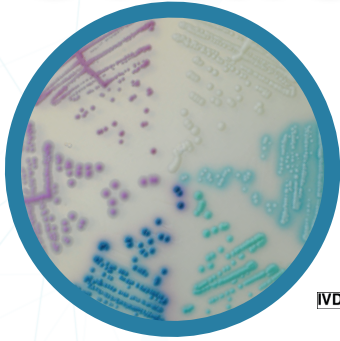

IVD CE

CHROMagar™ Candida Plus

Para la detección y diferenciación de las principales especies de *Candida*, incluida *C. auris*

100 % Sensibilidad/ Especificidad⁽¹⁾

⁽¹⁾ Mulet Bayona et al., 2022. *J. of Fungi*.




IVD CE

CHROMagar™ Orientation

Para el aislamiento y diferenciación de patógenos del tracto urinario

100 % Sensibilidad/ 98 % Especificidad⁽²⁾

⁽²⁾ Merlino et al. 1996. *J. Clin. Microbiol.*

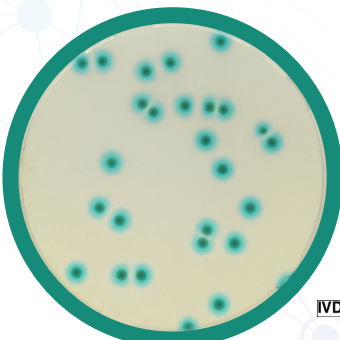


IVD CE

CHROMagar™ B.cepacia

Para la detección y enumeración del complejo *Burkholderia cepacia*

100 % Sensibilidad / 95 % Especificidad⁽³⁾

⁽³⁾ Katja Seme et al., 2022. *ASM Microbe*

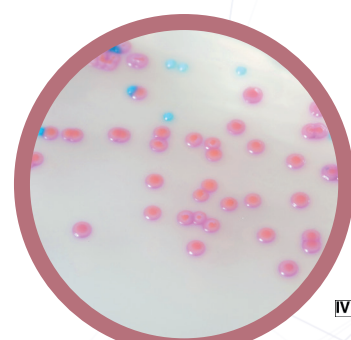


IVD CE

CHROMagar™ Staph aureus

Para el aislamiento y diferenciación directa de *Staphylococcus aureus*

95.4 % Sensibilidad/ 99.4 % Especificidad⁽⁴⁾

⁽⁴⁾ Gaillot et al., 2000. *J. Clin. Microbiol.*

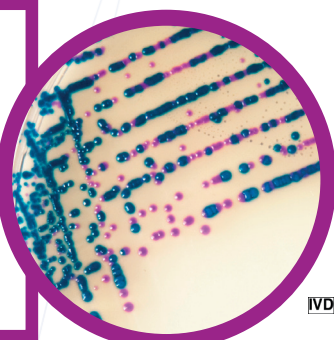

IVD CE


LIM RambaQUICK™ StrepB CHROMagar™ StrepB*

Para el aislamiento y diferenciación de *Streptococcus agalactiae* (SGB)

94 % Sensibilidad/ 100% Especificidad⁽⁵⁾

⁽⁵⁾ Salem & Anderson, 2015. *Pathology*

*This product can be used alone or with the method.

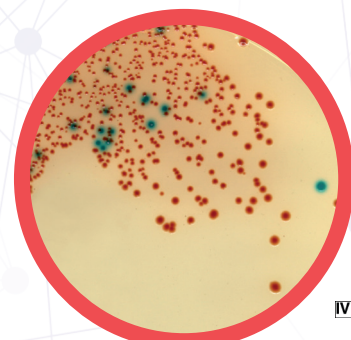


IVD CE

CHROMagar™ StrepA

Para la detección de estreptococos del grupo A en muestras de garganta

96,7 % Sensibilidad /100 % Especificidad⁽⁶⁾

⁽⁶⁾ Gaskin et al., 2019. *ASM Microbe*

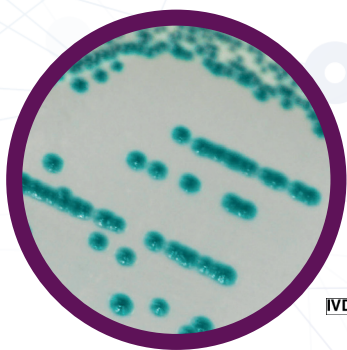


IVD CE

CHROMagar™ Serratia

Para la detección de
Serratia marcescens

100 % Sensibilidad / 97 % Especificidad ⁽⁷⁾

⁽⁷⁾ Gaskin et al., 2020. ECCMID

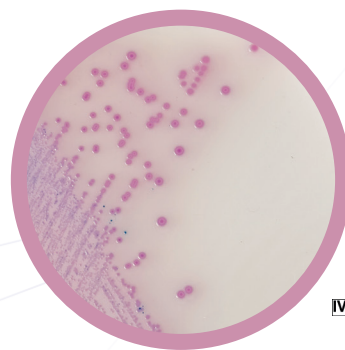

IVD CE


CHROMagar™ Salmonella

Para la detección y aislamiento
de *Salmonella*

95 % Sensibilidad ⁽⁸⁾ / **88,9 % Especificidad** ⁽⁸⁾ comparado

con un 78,5 % del Agar Hektoen

⁽⁸⁾ Gaillot et al., 1998. J. Clin. Microbiol.

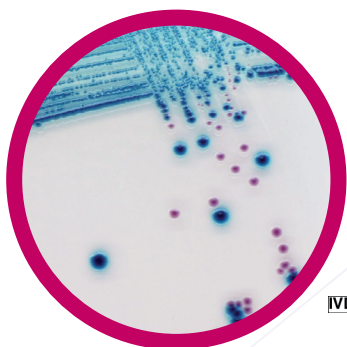


IVD CE

CHROMagar™ STEC

Para la detección de *E. coli* productor
de toxinas Shiga (STEC)

91.4 % Sensibilidad/ 86.7 % Especificidad ⁽⁹⁾

⁽⁹⁾ Gouali et al., 2013. Eur. J. Clin. Microbiol.

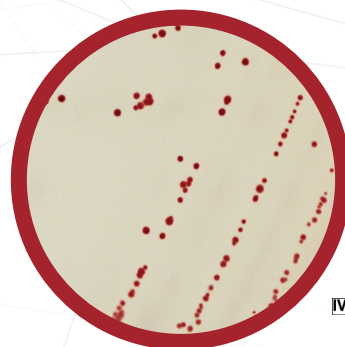


IVD CE

CHROMagar™ Campylobacter

Para la detección, diferenciación y enumeración de
Campylobacter termotolerantes

100 % Sensibilidad/ 94 % Especificidad ⁽¹⁰⁾

⁽¹⁰⁾ Bensersa-Nedjar et al., 2017. RICA

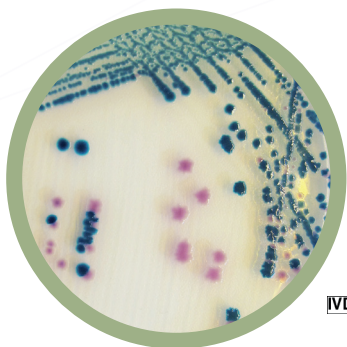

IVD CE

CHROMagar™ Y. enterocolitica

Para la detección y diferenciación de
Yersinia enterocolitica patógena

100 % Sensibilidad/ 99 % Especificidad ⁽¹¹⁾

⁽¹¹⁾ Renaud et al., 2013. J. Clin. Microbiol.

Disponible :



forma deshidratada

o en placas preparadas

